



Cert. #:4038.01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA	Certificado No. (Certificate #): 58459
General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro	Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-06-30
Quito, Ecuador	Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-06-30
(+593) 02 6040 607	Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2026-06
innovatec@innovatec.com.ec	Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-06-30

Cliente (Client): GLOBAL TRANS LOGISTICS GTL S.A.
Jose Miguel Guarderas S4-415 y de los Guabos / CALDERON

Información del Instrumento (Instrument Information)					
Equipo (Instrument):	Registrador de Temperatura y Humedad	Código (Code):	GTL-004	Int. de Medición:	(-25 a 70) °C
Marca (Brand):	THERMO KING	Ubicación (Location):	Contenedor GTL-004	(Measurement Range):	(0 a 100) %HR
Modelo (Model):	SmartReefer2	Lugar de Calibración (Place of Calibration):	In Situ	División de escala:	0.01 °C
Serie (Serial #):	INN-58459		On Site	(Resolution):	0.01 %HR

Datos de Calibración (Calibration Info)		Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)	
Procedimiento (Procedure):	INN-PC-24	Temperatura (Temp):	(21.8 a 21.5) °C Humedad (Humidity): (52.3 a 52.9)%HR

Trazabilidad (Traceability Info)				
Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Termohigrómetro	GOVEE	54330	2025-03-03	1 año

Resultados (Results)					
Nominal (Nominal)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)
16 °C	15.810 °C	15.31 °C	-0.502 °C	± 0.5 °C	± 0.18 °C
5 °C	5.197 °C	4.86 °C	-0.340 °C	± 0.5 °C	± 0.21 °C
45 %HR	44.57 %HR	47.13 %HR	2.56 %HR	± 5 %HR	± 2.9 %HR
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, o otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: Ninguna.
Comments

Calibrado por: Ing. Isaac Calle
Calibrated by:

Aprobado por:
Approved by:



Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.:

58459

Registrador de Temperatura y Humedad

Fecha de Calibración:

2025-06-30

THERMO KING

Tabla 1.0: Lecturas de la TEMPERATURA en el área de trabajo (°C)

Tiempo (hh:mm:ss)	Temperatura Patrón (°C)	Temperatura Calibrando (°C)	Error (°C)
11:30:00 AM	17.1	16.7	-0.40
11:31:00 AM	16.9	16.6	-0.30
11:32:00 AM	16.8	16.5	-0.30
11:33:00 AM	16.7	16.4	-0.30
11:34:00 AM	16.6	16.3	-0.30
11:35:00 AM	16.5	16.2	-0.30
11:36:00 AM	16.4	16.1	-0.30
11:37:00 AM	16.3	16.0	-0.30
11:38:00 AM	16.2	15.8	-0.40
11:39:00 AM	16.1	15.7	-0.45
11:40:00 AM	16.0	15.6	-0.45
11:41:00 AM	16.0	15.5	-0.50
11:42:00 AM	15.9	15.4	-0.55
11:43:00 AM	15.9	15.3	-0.65
11:44:00 AM	15.7	15.2	-0.55
11:45:00 AM	15.7	15.0	-0.75
11:46:00 AM	15.6	14.9	-0.70
11:47:00 AM	15.6	14.9	-0.75
11:48:00 AM	15.6	14.9	-0.70
11:49:00 AM	15.5	14.8	-0.70
11:50:00 AM	15.5	14.8	-0.70
11:51:00 AM	15.3	14.8	-0.50
11:52:00 AM	15.3	14.7	-0.60
11:53:00 AM	15.3	14.6	-0.70
11:54:00 AM	15.3	14.6	-0.70
11:55:00 AM	14.9	14.5	-0.40
11:56:00 AM	14.9	14.5	-0.40
11:57:00 AM	14.9	14.5	-0.40
11:58:00 AM	14.9	14.4	-0.50
11:59:00 AM	14.9	14.4	-0.50
Promedio	15.81	15.31	
Desviación	0.648	0.743	
Max	17.10	16.70	
Min	14.90	14.40	

Certificado No.:

58459

Registrador de Temperatura y Humedad

Fecha de Calibración:

2025-06-30

THERMO KING

Tabla 2.0: Lecturas de la TEMPERATURA en el área de trabajo (°C)

Tiempo (hh:mm:ss)	Temperatura Patrón (°C)	Temperatura Calibrando (°C)	Error (°C)
11:30:00 AM	12.2	12.5	0.30
11:31:00 AM	11.4	11.3	-0.15
11:32:00 AM	10.5	10.3	-0.25
11:33:00 AM	9.7	9.3	-0.45
11:34:00 AM	8.9	8.5	-0.40
11:35:00 AM	8.2	7.5	-0.70
11:36:00 AM	7.5	7.0	-0.50
11:37:00 AM	6.9	6.3	-0.65
11:38:00 AM	6.2	5.8	-0.45
11:39:00 AM	5.6	5.3	-0.35
11:40:00 AM	5.0	4.5	-0.50
11:41:00 AM	4.5	4.0	-0.50
11:42:00 AM	4.0	3.5	-0.50
11:43:00 AM	3.3	3.0	-0.30
11:44:00 AM	2.9	2.8	-0.15
11:45:00 AM	2.5	2.3	-0.25
11:46:00 AM	2.4	1.8	-0.65
11:47:00 AM	1.8	1.5	-0.30
11:48:00 AM	1.2	1.0	-0.20
11:49:00 AM	1.4	1.3	-0.15
11:50:00 AM	3.4	2.8	-0.65
11:51:00 AM	4.8	4.3	-0.55
11:52:00 AM	4.8	4.5	-0.30
11:53:00 AM	4.7	4.0	-0.70
11:54:00 AM	4.6	4.8	0.15
11:55:00 AM	4.7	5.3	0.55
11:56:00 AM	4.8	4.8	-0.05
11:57:00 AM	3.1	2.5	-0.60
11:58:00 AM	2.6	2.3	-0.35
11:59:00 AM	2.3	1.8	-0.55
Promedio	5.20	4.86	
Desviación	2.994	3.048	
Max	12.20	12.50	
Min	1.20	1.00	

Certificado No.:

58459

Registrador de Temperatura y Humedad

Fecha de Calibración:

2025-06-30

THERMO KING

Tabla 2.0: Lecturas de la HUMEDAD RELATIVA en el área de trabajo (%HR)

Tiempo (hh:mm:ss)	Humedad Relativa Patrón (%HR)	Humedad Relativa Calibrando (%HR)	Error (%HR)
8:58:00 AM	49	49.00	0.00
8:59:00 AM	46.8	38.00	-8.80
9:00:00 AM	45.1	38.00	-7.10
9:01:00 AM	43.2	38.00	-5.20
9:02:00 AM	42.0	38.00	-4.00
9:03:00 AM	40.9	38.00	-2.90
9:04:00 AM	40.2	38.00	-2.20
9:05:00 AM	38.9	38.00	-0.90
9:06:00 AM	38.5	39.00	0.50
9:07:00 AM	38.0	39.00	1.00
9:08:00 AM	37.6	39.00	1.40
9:09:00 AM	37.1	40.00	2.90
9:10:00 AM	36.8	40.00	3.20
9:11:00 AM	36.4	42.00	5.60
9:12:00 AM	36.4	42.00	5.60
9:13:00 AM	38.6	44.00	5.40
9:14:00 AM	38.3	45.00	6.70
9:15:00 AM	39.3	47.00	7.70
9:16:00 AM	41.4	48.00	6.60
9:17:00 AM	43.4	52.00	8.60
9:18:00 AM	46.6	55.00	8.40
9:19:00 AM	52.4	62.00	9.60
9:20:00 AM	58.6	67.00	8.40
9:21:00 AM	62.4	69.00	6.60
9:22:00 AM	62.0	69.00	7.00
9:23:00 AM	55.1	52.00	-3.10
9:24:00 AM	51.5	52.00	0.50
9:25:00 AM	48.9	52.00	3.10
9:26:00 AM	46.7	52.00	5.30
9:27:00 AM	45.1	52.00	6.90
Promedio	44.57	47.13	
Desviación	7.559	9.705	
Max	62.40	69.00	
Min	36.40	38.00	

Certificado No.:

58459


Registrador de Temperatura y Humedad

Fecha de Calibración:


2025-06-30

THERMO KING

Curva de Calibración - TEMPERATURA

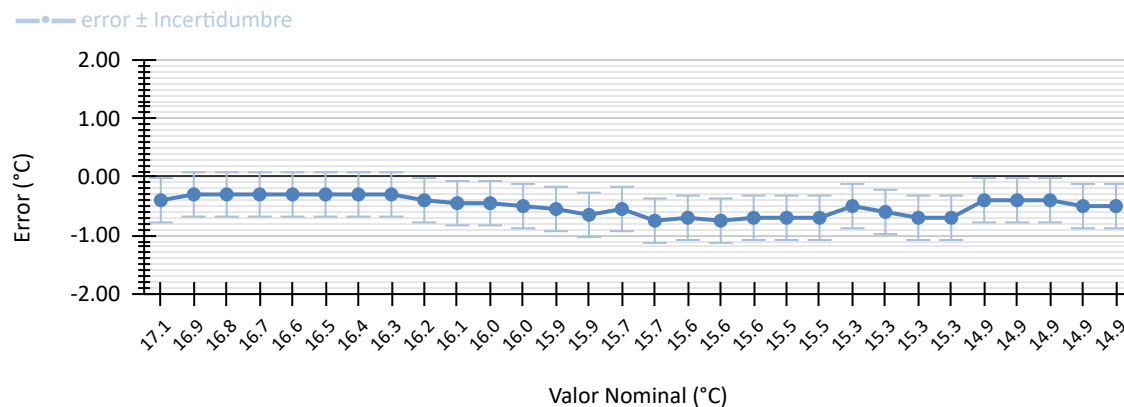

Curva de Calibración - TEMPERATURA

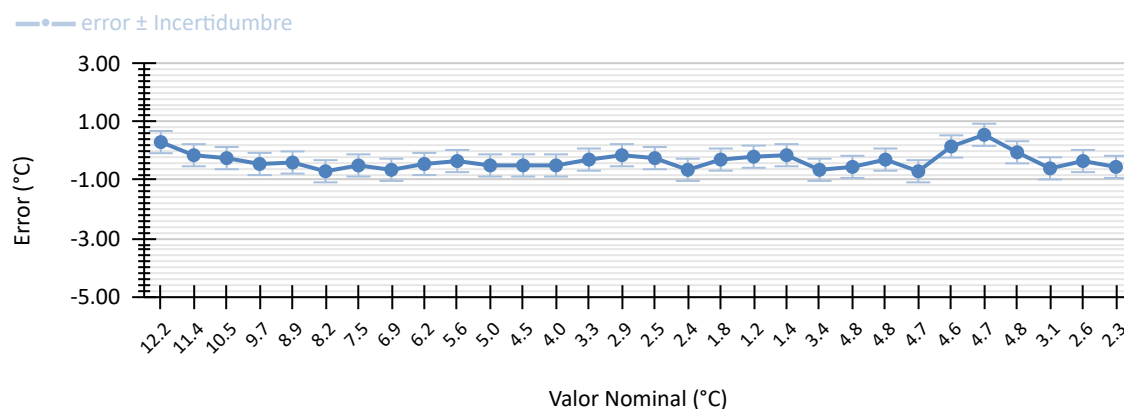

Curva de Calibración - % HUMEDAD RELATIVA

