

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

Certificado No. (Certificate #): 58912

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-07-11

Quito, Ecuador

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-07-11

(+593) 02 6040 607

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2027-07

innovatec@innovatec.com.ec

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-07-11

Cliente (Client): UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. CARLOS JULIO AROSEMENA S/N, GUAYAQUIL, GUAYAS

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Balanza	Capacidad Máx. (Max Capacity)	35 kg	Ubicación: (Location)	Laboratorio de Carreteras
Marca (Brand):	Ohaus	División de escala: (Resolution)	d: 0.1 kg / e: 100 g	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	In Situ On Site
Modelo (Model):	RD35LM	Clase (Class):	Ordinaria (III)		
Serie (Serial #):	3393083-7LQ				
Código (Code):	*****				

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-13

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)



Temperatura (Temp): (27.2 °C a 27.5 °C)

Humedad (Humidity): (65.1 %HR a 65 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Pesas F1 (0.3 a 5) kg	Rice Lake	SECM-M-2024-230-231-232-233	2025-05-07	1 año
Pesas M1	-	55798	2025-04-09	1 año
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Ejemplo Distribución de Excentricidad:

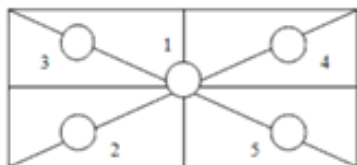

Cumplimiento de la balanza:

La balanza cumple con los errores máximos permitidos, dados en la OIML R76-1 en las siguientes pruebas:

Excentricidad:	Cumple
Linealidad:	Cumple
Repetibilidad:	Cumple

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, o otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Ninguno.
Comments

Calibrado por: Jonathan Fonseca
Calibrated by:

Aprobado por:
Approved by:



Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 58912
 Fecha de Calibración: 2025-07-11

Equipo (Instrument): Balanza
 Marca (Brand): Ohaus

Resultados (Results)

Linealidad:

Patrón (Standard)	UBT (UUT)		Error (Error)		E.M.P (±)	Histéresis	Incertidumbre
	Ascendente	Descendente	Ascendente	Descendente	Tolerance (±)	(Histerisis)	(Uncertainty)
1 kg	1.1 kg	1.1 kg	0.1 kg	0.1 kg	0.1 kg	0 kg	± 0.082 kg
2 kg	2.1 kg	2.1 kg	0.1 kg	0.1 kg	0.1 kg	0 kg	± 0.082 kg
5 kg	5.1 kg	5.1 kg	0.1 kg	0.1 kg	0.1 kg	0 kg	± 0.082 kg
8 kg	8.2 kg	8.2 kg	0.2 kg	0.2 kg	0.2 kg	0 kg	± 0.082 kg
10 kg	10.2 kg	10.2 kg	0.2 kg	0.2 kg	0.2 kg	0 kg	± 0.082 kg
15 kg	15.2 kg	15.2 kg	0.2 kg	0.2 kg	0.2 kg	0 kg	± 0.082 kg
20 kg	20.2 kg	20.2 kg	0.2 kg	0.2 kg	0.2 kg	0 kg	± 0.082 kg
25 kg	25.3 kg	25.3 kg	0.3 kg	0.3 kg	0.3 kg	0 kg	± 0.082 kg
30 kg	30.3 kg	30.3 kg	0.3 kg	0.3 kg	0.3 kg	0 kg	± 0.082 kg
35 kg	35.3 kg	35.3 kg	0.3 kg	0.3 kg	0.3 kg	0 kg	± 0.082 kg

Excentricidad:

Patrón (Standard)	Posición					Exceso Máximo (Max. Excess)	E.M.P (±) Tolerance (±)
	Superior Izquierda	Inferior Izquierda	Centro	Superior Derecha	Inferior Derecha		
10 kg	10.2 kg	10.2 kg	10.2 kg	10.2 kg	10.2 kg	0 kg	0.2 kg

Repetibilidad:

Patrón (Standard)	UBT (UUT)	Diferencia Máx. (Max. Difference)	E.M.P (±) Tolerance (±)	Patrón (Standard)	UBT (UUT)	Diferencia Máx. (Max. Difference)	E.M.P (±) Tolerance (±)
	17.7 kg				35.3 kg		
	17.7 kg				35.3 kg		
	17.7 kg				35.3 kg		
	17.7 kg				35.3 kg		
17.5 kg	17.7 kg	0 kg	0.2 kg	35 kg	35.3 kg	0 kg	0.3 kg
	17.7 kg				35.3 kg		
	17.7 kg				35.3 kg		
	17.7 kg				35.3 kg		
	17.7 kg				35.3 kg		
	17.7 kg				35.3 kg		