


Patrón (<i>Standard</i>)	UBP (<i>UUT</i>)	Error (<i>Error</i>)	Exactitud (<i>Accuracy</i>)	Incertidumbre (<i>Uncertainty</i>)	
1 mm	0.99 mm	-10 µm	± 25 µm	±	5.8E+00 µm
1.25 mm	1.24 mm	-10 µm	± 25 µm	±	5.8E+00 µm
1.5 mm	1.49 mm	-10 µm	± 25 µm	±	5.8E+00 µm
2 mm	1.98 mm	-20 µm	± 25 µm	±	5.8E+00 µm
3 mm	2.98 mm	-20 µm	± 25 µm	±	5.8E+00 µm
4 mm	3.99 mm	-10 µm	± 25 µm	±	5.8E+00 µm
5 mm	4.98 mm	-20 µm	± 25 µm	±	5.8E+00 µm
10 mm	9.98 mm	-20 µm	± 25 µm	±	5.8E+00 µm

Parametro	Modelo	Serie	Tolerancia	Valor Nominal	Valor Encontrado	Pasa/No Pasa
Medición Mando	DEPSET-25	10068	± 0.50 mm	25 mm	25.02 mm	Pasa
Medición Mando	DDAPT A	30089	± 0.50 mm	20 mm	20.02 mm	Pasa
Medición Mando	DDAPT B	30089	± 0.50 mm	20 mm	20.03 mm	Pasa
Medición Mando Go	GNGDEP	20071	+ 0.50 mm	23 mm	23.04 mm	Pasa
Med. Mando No Go	GNGDEP	20071	- 0.50 mm	27 mm	26.88 mm	Pasa
Inclinación Cero	LEVEL-UN	40056	Anillo de Centro	0 °	Aniilo de Centro	Pasa
Inclinación 0.1 in/ft	LEVEL-UN	40056	Segundo Anillo	0.1 in/ft	Segundo Anillo	Pasa

Figura 1. Medición de Mando

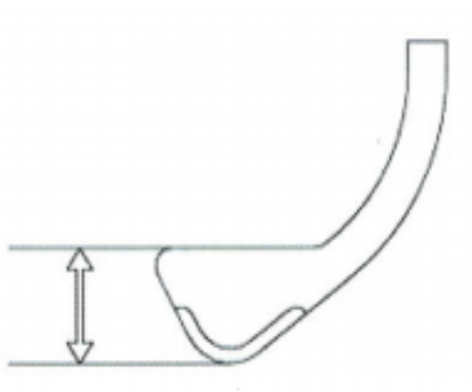

Incertidumbre de Medida:
Medición de Mando: ± 10 µm
Medición de Inclinación: ± 0.012 °