

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 50936

Fecha de Recepción (Reception Date): 2024-10-24

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2024-10-24

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): -

Fecha de Emisión (Emission Date): 2024-10-24

Cliente (Client):

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO

Calle Río Baba #143 y Pasaje Río Saloya,, SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Autoclave	Int. de Medición: (Measurement Range)	(105 - 135) °C	Ubicación (Location):	LDR SANTO DOMINGO - ÁREA DE MICROBIOLOGÍA
Marca (Brand):	Zealway				
Modelo (Model):	GI80TR	División de escala: (Resolution)	0.1 °C	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	In Situ / On Site
Serie (Serial #):	A10219004NFA				
Código (Code):	LDR/23/MB/EA/004				

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-29

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Temperatura (Temp): (23.5 °C a 24.8 °C)

Humedad (Humidity): (55.7 %HR a 52.5 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Datalogger	Lascar	45474	2024-05-10	1 año
-	-	-	-	-

Resultados (Results)

Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)	Estabilidad (Stability)	Uniformidad (Uniformity)
°C	°C	°C			Axial / Radial
120.98	121.00	0.020	± 0.60 °C	± 0.30 °C	± 0 °C / ± 0 °C
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de k=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of k=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios:

Comments

UBP: Unidad Bajo Prueba

Calibrado por:

Calibrated by:

Jonathan Fonseca


Aprobado por:

Approved by:



Certificado No.: 50936
Fecha de Calibración: 2024-10-24

Equipo (Instrument): Autoclave
Marca (Brand): Zealway

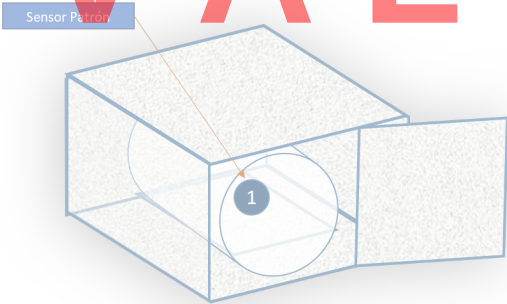

UBICACION DE EQUIPO PATRON


Tabla 1.0: Lecturas de los sensores patrón en el área de trabajo a 121 °C

Tiempo (hh:mm:ss)	Lectura del Patrón °C @ 121 °C						Promedio
	Temperatura Calibrando	Sensor 1	Sensor 2	Sensor 3	Sensor 4	Sensor 5	
11:20:00 AM	121.0	120.80					120.80
11:20:30 AM	121.0	120.80					120.80
11:21:00 AM	121.0	120.80					120.80
11:21:30 AM	121.2	120.80					120.80
11:22:00 AM	121.2	120.90					120.90
11:22:30 AM	121.2	120.90					120.90
11:23:00 AM	121.2	120.90					120.90
11:23:30 AM	121.2	120.90					120.90
11:24:00 AM	121.2	121.00					121.00
11:24:30 AM	121.2	121.00					121.00
11:25:00 AM	121.4	121.00					121.00
11:25:30 AM	121.4	121.00					121.00
11:26:00 AM	121.4	121.00					121.00
11:26:30 AM	121.4	121.00					121.00
11:27:00 AM	121.5	121.00					121.00
11:27:30 AM	121.5	121.00					121.00
11:28:00 AM	121.5	121.00					121.00
11:28:30 AM	121.5	121.00					121.00
11:29:00 AM	121.5	121.10					121.10
11:29:30 AM	121.5	121.10					121.10
11:30:00 AM	121.4	121.10					121.10
11:30:30 AM	121.4	121.10					121.10
11:31:00 AM	121.4	121.10					121.10
11:31:30 AM	121.4	121.10					121.10
11:32:00 AM	121.4	121.10					121.10
11:32:30 AM	121.4	121.00					121.00
11:33:00 AM	121.4	121.00					121.00
11:33:30 AM	121.4	121.00					121.00
11:34:00 AM	121.4	121.00					121.00
11:34:30 AM	121.4	121.00					121.00
Promedio	121.0	120.98					120.98
Error en cada ubicación:		0.02					
Max	121.50	121.10					
Min	121.00	120.80					
Desviación Std	0.095						
Estabilidad	0.30						
ΔT Radial	0.0						
ΔT Axial	0.0						

NO VALIDO

Certificado No.: 50936
Fecha de Calibración: 2024-10-24

Equipo (Instrument): Autoclave
Marca (Brand): Zealway

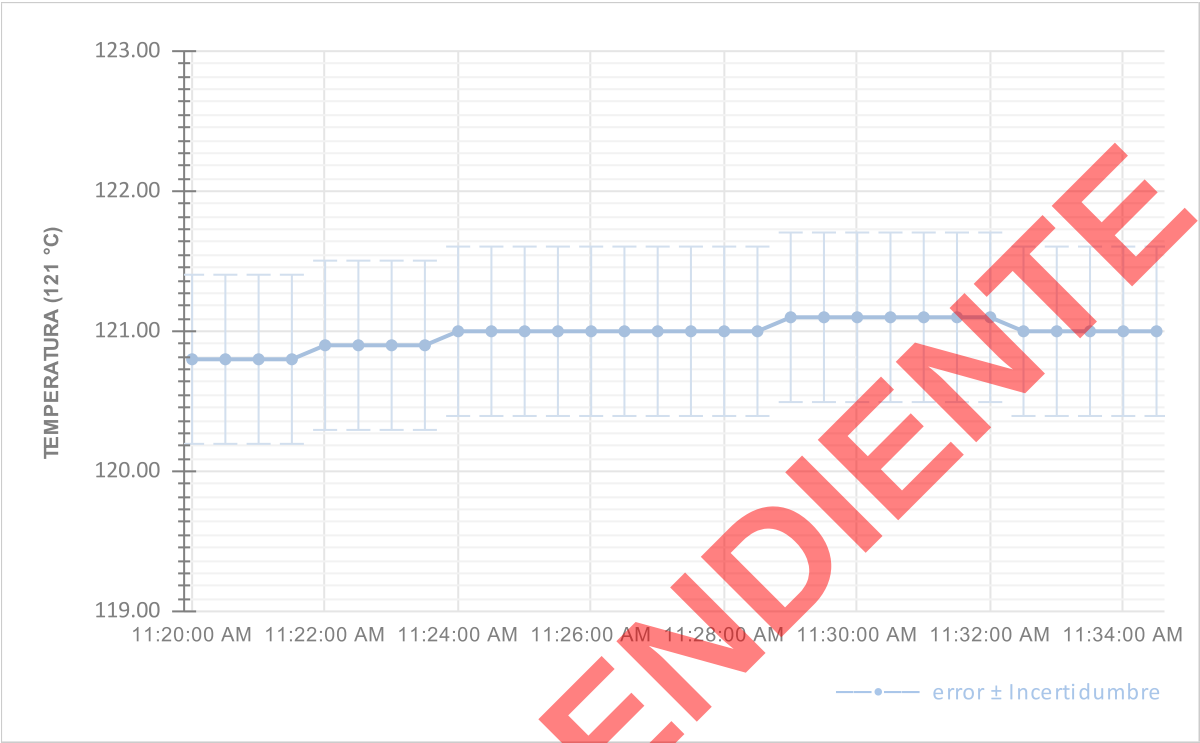

PAGO