

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 54042

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-02-11

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-02-11

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2026-02

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-02-11

Cliente (Client): TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS SYTSA CIA. LTDA
DIEGO DE VAZQUEZ N77-670 Y NOVENA, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument): Controlador de Temperatura

Marca (Brand): CARRIER

Modelo (Model): *****

Serie (Serial #): 0551660439

Código (Code): CR-147

Ubicación:
(Location):

Lugar de Calibración: In Situ
(Place of Calibration): In Situ

Int. de Medición:
(Measurement Range) (-18 a 0) °C

División de escala:
(Resolution) 0.1 °C

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-02

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Temperatura (Temp): (18.8 a 18.3) °C **Humedad (Humidity):** (48.3 a 47.4) %HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
PRT	Isotech	AC-28719	2023-05-15	2 años
Advanced Multimeter	Transmille	51065	2024-03-26	2 años

Resultados (Results)

Nominal (Nominal)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	EMP (MPE)	Incertidumbre (Uncertainty)
-18 °C	-18.1 °C	-17.7 °C	0.4 °C	± 1 °C	± 0.79 °C
-10 °C	-10.1 °C	-9.8 °C	0.3 °C	± 1 °C	± 0.79 °C
0 °C	0 °C	-0.2 °C	-0.2 °C	± 1 °C	± 0.79 °C

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud a través del Patrón Nacional, de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement through National Standards through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: Ninguno
Comments

Calibrado por: Ing. Patricio Llerena
Calibrated by:


Aprobado por:
Approved by:



Tabla 1: Lecturas de la Temperatura


Número (Nº)	Patrón	UBP	Error	Patrón	UBP	Error	Patrón	UBP	Error
1	-18.1 °C	-17.7 °C	0.4 °C	-10.1 °C	-9.8 °C	0.3 °C	0 °C	-0.2 °C	-0.2 °C
2	-18.1 °C	-17.7 °C	0.4 °C	-10.1 °C	-9.8 °C	0.3 °C	0 °C	-0.2 °C	-0.2 °C
3	-18.1 °C	-17.7 °C	0.4 °C	-10.1 °C	-9.8 °C	0.3 °C	0 °C	-0.2 °C	-0.2 °C
4	-18.1 °C	-17.7 °C	0.4 °C	-10.1 °C	-9.8 °C	0.3 °C	0 °C	-0.2 °C	-0.2 °C
5	-18.1 °C	-17.7 °C	0.4 °C	-10.1 °C	-9.8 °C	0.3 °C	0 °C	-0.2 °C	-0.2 °C
6	-18.1 °C	-17.7 °C	0.4 °C	-10.1 °C	-9.8 °C	0.3 °C	0 °C	-0.2 °C	-0.2 °C
7	-18.1 °C	-17.7 °C	0.4 °C	-10.1 °C	-9.8 °C	0.3 °C	0 °C	-0.2 °C	-0.2 °C
8	-18.1 °C	-17.7 °C	0.4 °C	-10.1 °C	-9.8 °C	0.3 °C	0 °C	-0.2 °C	-0.2 °C
9	-18.1 °C	-17.7 °C	0.4 °C	-10.1 °C	-9.8 °C	0.3 °C	0 °C	-0.2 °C	-0.2 °C
10	-18.1 °C	-17.7 °C	0.4 °C	-10.1 °C	-9.8 °C	0.3 °C	0 °C	-0.2 °C	-0.2 °C
11	-18.1 °C	-17.7 °C	0.4 °C	-10.1 °C	-9.8 °C	0.3 °C	0 °C	-0.2 °C	-0.2 °C
12	-18.1 °C	-17.7 °C	0.4 °C	-10.1 °C	-9.8 °C	0.3 °C	0 °C	-0.2 °C	-0.2 °C
13	-18.1 °C	-17.7 °C	0.4 °C	-10.1 °C	-9.8 °C	0.3 °C	0 °C	-0.2 °C	-0.2 °C
14	-18.1 °C	-17.7 °C	0.4 °C	-10.1 °C	-9.8 °C	0.3 °C	0 °C	-0.2 °C	-0.2 °C
15	-18.1 °C	-17.7 °C	0.4 °C	-10.1 °C	-9.8 °C	0.3 °C	0 °C	-0.2 °C	-0.2 °C
16	-18.1 °C	-17.7 °C	0.4 °C	-10.1 °C	-9.8 °C	0.3 °C	0 °C	-0.2 °C	-0.2 °C
17	-18.1 °C	-17.7 °C	0.4 °C	-10.1 °C	-9.8 °C	0.3 °C	0 °C	-0.2 °C	-0.2 °C
18	-18.1 °C	-17.7 °C	0.4 °C	-10.1 °C	-9.8 °C	0.3 °C	0 °C	-0.2 °C	-0.2 °C
19	-18.1 °C	-17.7 °C	0.4 °C	-10.1 °C	-9.8 °C	0.3 °C	0 °C	-0.2 °C	-0.2 °C
20	-18.1 °C	-17.7 °C	0.4 °C	-10.1 °C	-9.8 °C	0.3 °C	0 °C	-0.2 °C	-0.2 °C

Curva de Calibración -18 °C

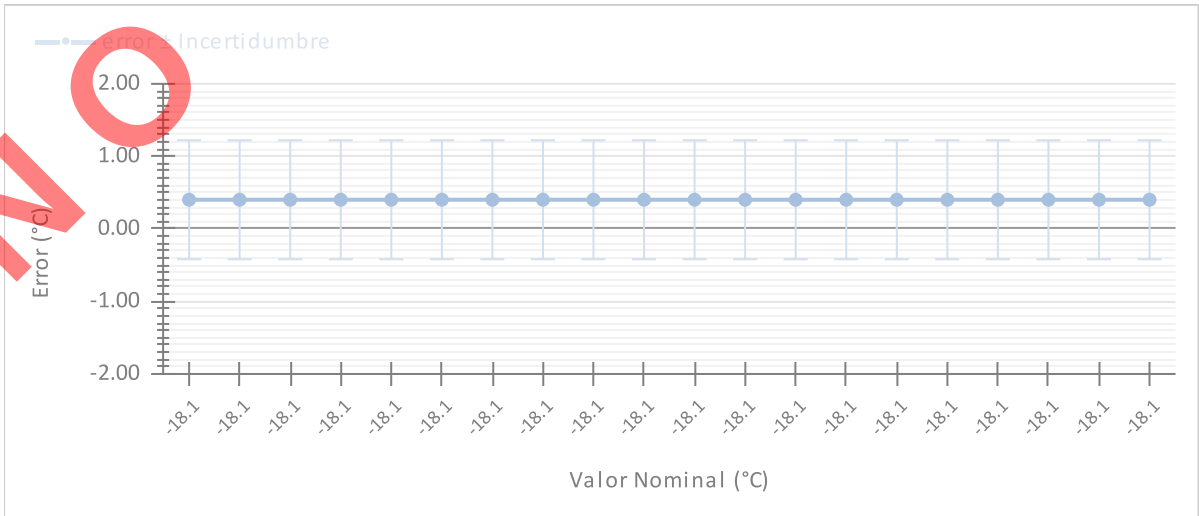


NO VALIDO

Curva de Calibración -10 °C

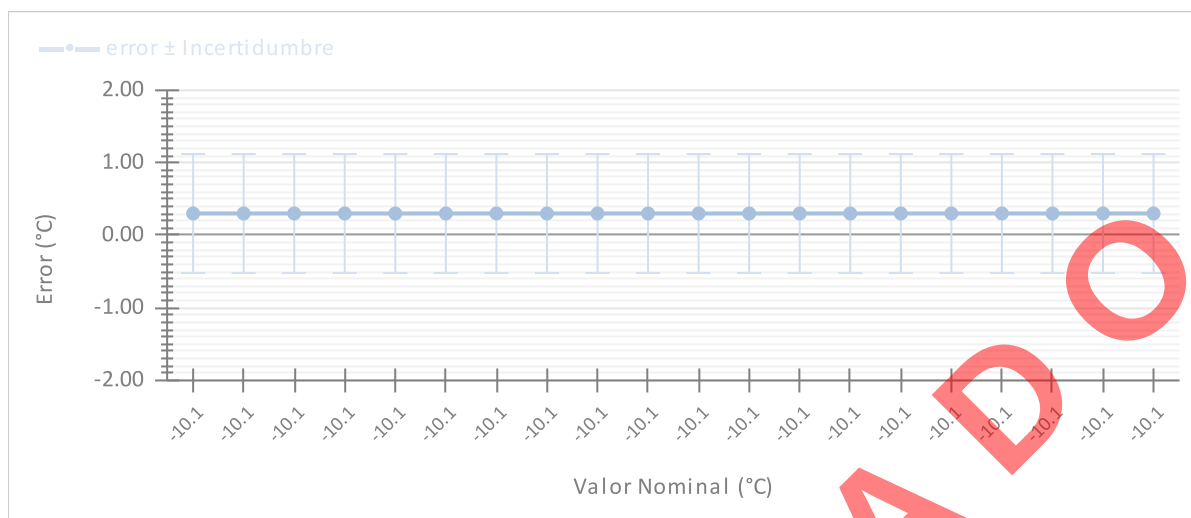

Curva de Calibración 0 °C

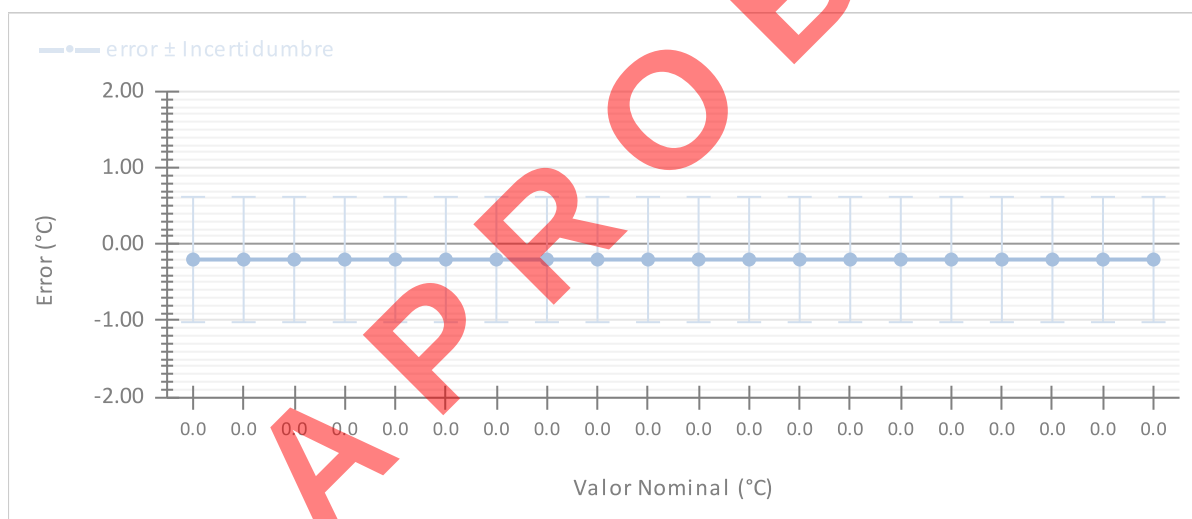

Fin de Certificado (End of Certificate)