

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 38316

Fecha de Recepción (Reception Date): 2023-09-15

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2023-09-21

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): -

Fecha de Emisión (Emission Date): 2023-09-25

Cliente (Client): AVIANCA - ECUADOR S.A.
 AV LA CORUÑA E11-38 Y BELLO HORIZONTE, QUITO, PICHINCHA

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Horno de Pozo Seco	Int. de Medición: (Measurement Range)	(33 a 425) °C	Ubicación: (Location):	Laboratorio.
Marca (Brand):	Additel				
Modelo (Model):	ADT878PC-425	División de escala: (Resolution)	0.01 °C	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	Lab. INNOVATEC INNOVATEC's Lab.
Serie (Serial #):	670H22030002				

Datos de Calibración (Calibration Info)
Procedimiento (Procedure): INN-PC-29

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)
Temp. Inicial (Initial Temp.): 22.3 °C

Hum. Inicial (Initial Hum.): 60 %HR

Temp. Final (Final Temp.): 22.8 °C

Hum. Final (Final Hum.): 62 %HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multímetro Patrón	Transmille	AC-28786	2023-06-08	2 años
PRT	Isotech	AC-28719	2023-05-15	2 años
PRT	Isotech	33841	2023-04-01	1 año
PRT	Isotech	33842	2023-04-01	1 año
PRT	Isotech	33843	2023-04-01	1 año
PRT	Isotech	33844	2023-04-01	1 año

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjunta

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Ninugno.
Comments
Calibrado por: Ing. Mateo Bórquez
Calibrated by:
Aprobado por:
Approved by:

Firmado electrónicamente por
Ing. Diego Almeida
Gerente General
Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 38316

Equipo (Instrument): Horno de Pozo Seco


Fecha de Calibración: 2023-09-21

Marca (Brand): Additel


Nominal (Nominal)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Precisión (Accuracy)	Estabilidad (Stability)	Uniformidad (Uniformity)	Incertidumbre (Uncertainty)
50 °C	49.9262 °C	50 °C	0.0738 °C	± 0.2 °C	0.0045 °C	0.0045 °C	± 0.061 °C
200 °C	199.9399 °C	200 °C	0.0601 °C	± 0.2 °C	0.0190 °C	0.0190 °C	± 0.077 °C
400 °C	400.0723 °C	400 °C	-0.0723 °C	± 0.2 °C	0.0246 °C	0.0190 °C	± 0.094 °C

Graficos (Graphs):


Punto: 50 °C

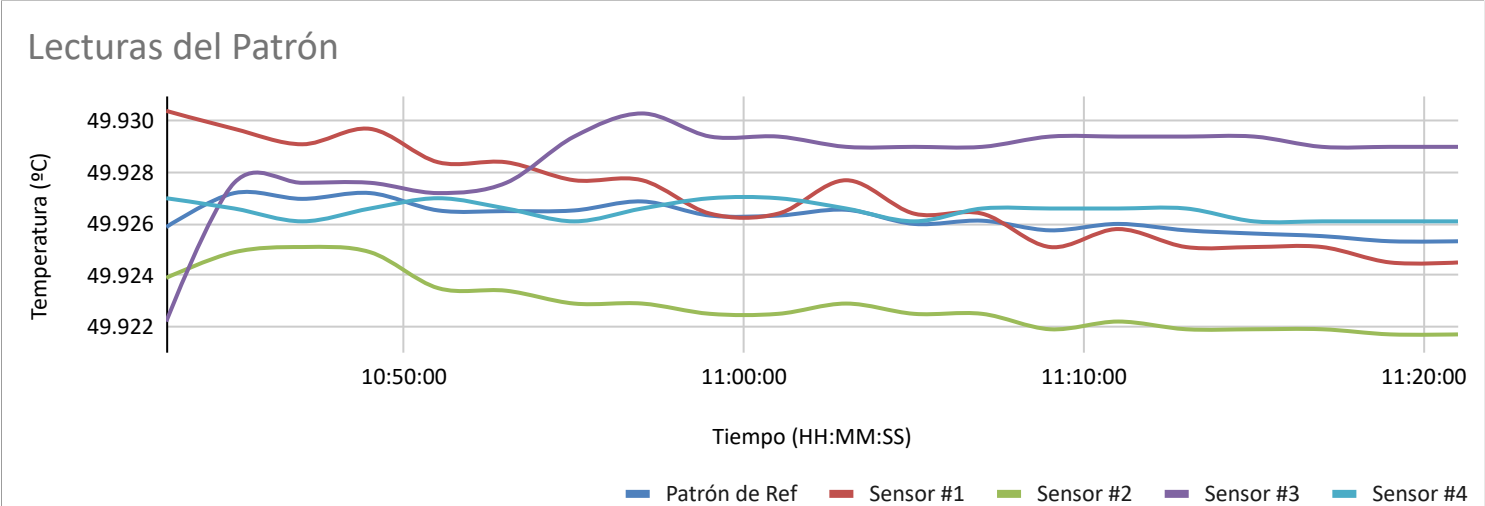

Punto: 200 °C

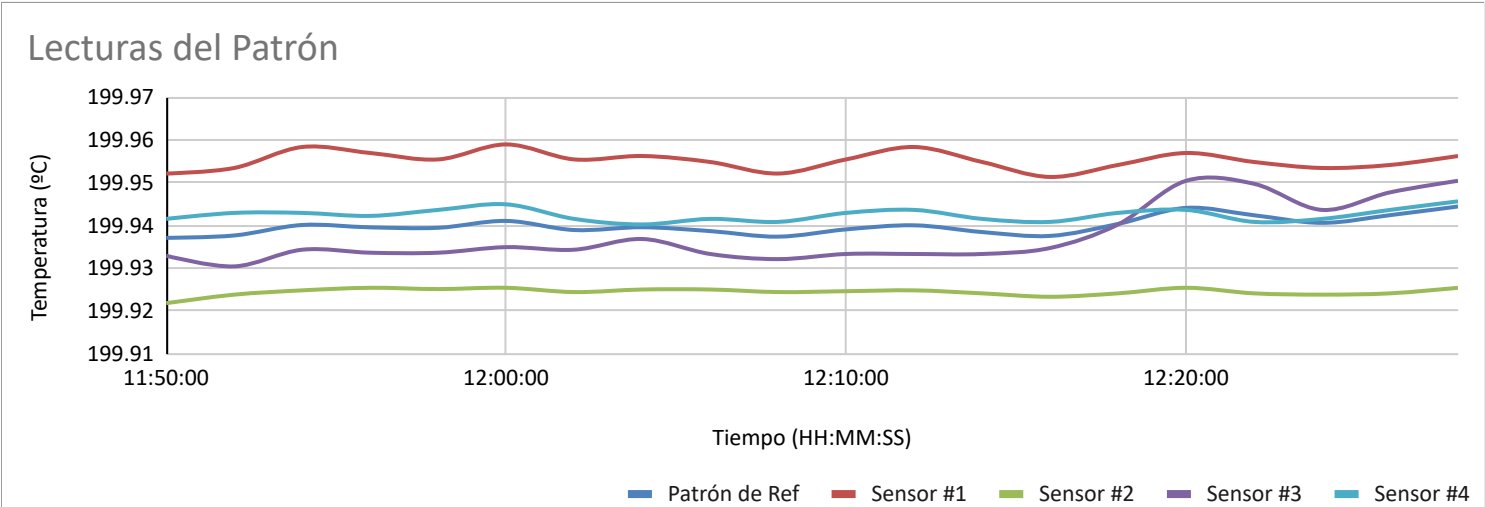

Punto: 400 °C

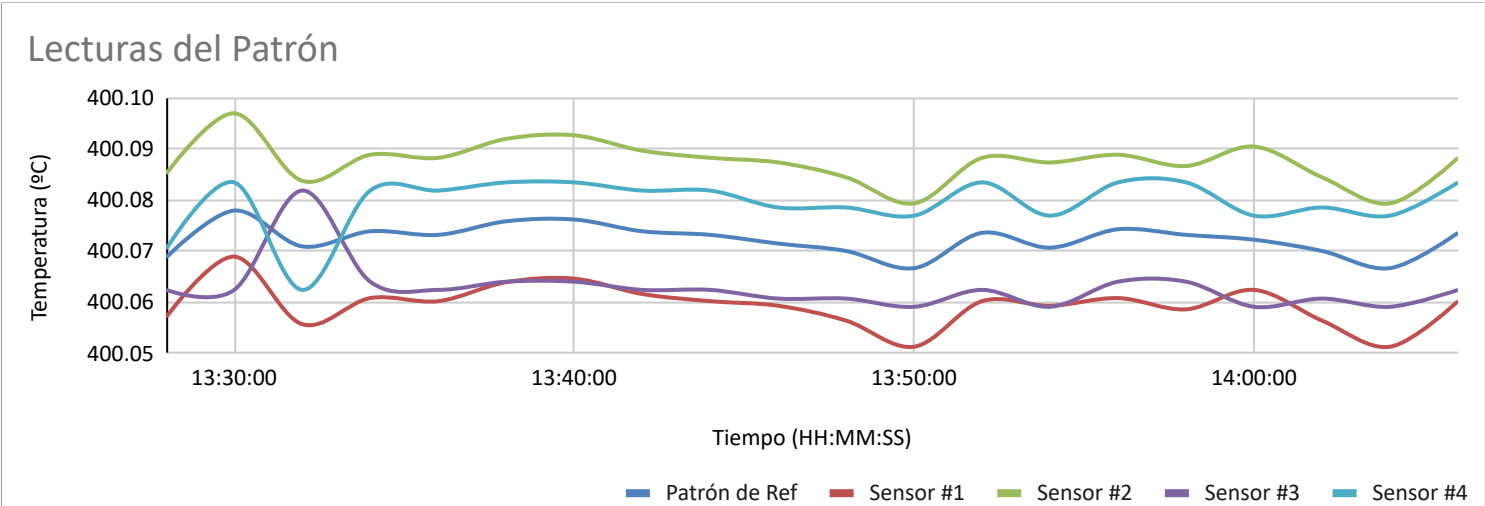

Certificado No.: 38316

Equipo (Instrument): Horno de Pozo Seco

Fecha de Calibración: 2023-09-21

Marca (Brand): Additel

Punto: 50 °C

Hora (Time)	UBP (UUT)	Patrón de Ref (Ref. Standard)	Sensor #1 (Sensor #1)	Sensor #2 (Sensor #2)	Sensor #3 (Sensor #3)	Sensor #4 (Sensor #4)	Error (Error)
10:43:00	50 °C	49.9259 °C	49.9304 °C	49.9239 °C	49.9222 °C	49.9270 °C	0.0741 °C
10:45:00	50 °C	49.9272 °C	49.9297 °C	49.9249 °C	49.9276 °C	49.9266 °C	0.0728 °C
10:47:00	50 °C	49.9270 °C	49.9291 °C	49.9251 °C	49.9276 °C	49.9261 °C	0.0730 °C
10:49:00	50 °C	49.9272 °C	49.9297 °C	49.9249 °C	49.9276 °C	49.9266 °C	0.0728 °C
10:51:00	50 °C	49.9265 °C	49.9284 °C	49.9235 °C	49.9272 °C	49.9270 °C	0.0735 °C
10:53:00	50 °C	49.9265 °C	49.9284 °C	49.9234 °C	49.9276 °C	49.9266 °C	0.0735 °C
10:55:00	50 °C	49.9265 °C	49.9277 °C	49.9229 °C	49.9294 °C	49.9261 °C	0.0735 °C
10:57:00	50 °C	49.9269 °C	49.9277 °C	49.9229 °C	49.9303 °C	49.9266 °C	0.0731 °C
10:59:00	50 °C	49.9263 °C	49.9264 °C	49.9225 °C	49.9294 °C	49.9270 °C	0.0737 °C
11:01:00	50 °C	49.9263 °C	49.9264 °C	49.9225 °C	49.9294 °C	49.9270 °C	0.0737 °C
11:03:00	50 °C	49.9266 °C	49.9277 °C	49.9229 °C	49.9290 °C	49.9266 °C	0.0734 °C
11:05:00	50 °C	49.9260 °C	49.9264 °C	49.9225 °C	49.9290 °C	49.9261 °C	0.0740 °C
11:07:00	50 °C	49.9261 °C	49.9264 °C	49.9225 °C	49.9290 °C	49.9266 °C	0.0739 °C
11:09:00	50 °C	49.9258 °C	49.9251 °C	49.9219 °C	49.9294 °C	49.9266 °C	0.0742 °C
11:11:00	50 °C	49.9260 °C	49.9258 °C	49.9222 °C	49.9294 °C	49.9266 °C	0.0740 °C
11:13:00	50 °C	49.9258 °C	49.9251 °C	49.9219 °C	49.9294 °C	49.9266 °C	0.0742 °C
11:15:00	50 °C	49.9256 °C	49.9251 °C	49.9219 °C	49.9294 °C	49.9261 °C	0.0744 °C
11:17:00	50 °C	49.9255 °C	49.9251 °C	49.9219 °C	49.9290 °C	49.9261 °C	0.0745 °C
11:19:00	50 °C	49.9253 °C	49.9245 °C	49.9217 °C	49.9290 °C	49.9261 °C	0.0747 °C
11:21:00	50 °C	49.9253 °C	49.9245 °C	49.9217 °C	49.9290 °C	49.9261 °C	0.0747 °C

Punto: 200 °C

Hora (Time)	UBP (UUT)	Patrón de Ref (Ref. Standard)	Sensor #1 (Sensor #1)	Sensor #2 (Sensor #2)	Sensor #3 (Sensor #3)	Sensor #4 (Sensor #4)	Error (Error)
11:50:00	200 °C	199.9371 °C	199.9521 °C	199.9218 °C	199.9329 °C	199.9415 °C	0.0629 °C
11:52:00	200 °C	199.9376 °C	199.9534 °C	199.9238 °C	199.9304 °C	199.9429 °C	0.0624 °C
11:54:00	200 °C	199.9401 °C	199.9583 °C	199.9248 °C	199.9343 °C	199.9429 °C	0.0599 °C
11:56:00	200 °C	199.9395 °C	199.9569 °C	199.9254 °C	199.9336 °C	199.9422 °C	0.0605 °C
11:58:00	200 °C	199.9394 °C	199.9554 °C	199.9251 °C	199.9336 °C	199.9436 °C	0.0606 °C
12:00:00	200 °C	199.9410 °C	199.9589 °C	199.9254 °C	199.9349 °C	199.9449 °C	0.0590 °C
12:02:00	200 °C	199.9389 °C	199.9554 °C	199.9244 °C	199.9343 °C	199.9415 °C	0.0611 °C
12:04:00	200 °C	199.9396 °C	199.9562 °C	199.9250 °C	199.9368 °C	199.9402 °C	0.0605 °C
12:06:00	200 °C	199.9387 °C	199.9548 °C	199.9250 °C	199.9333 °C	199.9415 °C	0.0613 °C
12:08:00	200 °C	199.9374 °C	199.9521 °C	199.9244 °C	199.9321 °C	199.9408 °C	0.0627 °C
12:10:00	200 °C	199.9391 °C	199.9554 °C	199.9246 °C	199.9333 °C	199.9429 °C	0.0609 °C
12:12:00	200 °C	199.9400 °C	199.9583 °C	199.9248 °C	199.9333 °C	199.9436 °C	0.0600 °C
12:14:00	200 °C	199.9384 °C	199.9548 °C	199.9241 °C	199.9333 °C	199.9415 °C	0.0616 °C
12:16:00	200 °C	199.9375 °C	199.9513 °C	199.9233 °C	199.9347 °C	199.9408 °C	0.0625 °C
12:18:00	200 °C	199.9403 °C	199.9541 °C	199.9241 °C	199.9402 °C	199.9429 °C	0.0597 °C
12:20:00	200 °C	199.9441 °C	199.9569 °C	199.9254 °C	199.9504 °C	199.9436 °C	0.0559 °C
12:22:00	200 °C	199.9424 °C	199.9548 °C	199.9241 °C	199.9497 °C	199.9408 °C	0.0576 °C
12:24:00	200 °C	199.9406 °C	199.9534 °C	199.9238 °C	199.9436 °C	199.9415 °C	0.0594 °C
12:26:00	200 °C	199.9424 °C	199.9541 °C	199.9241 °C	199.9477 °C	199.9436 °C	0.0576 °C
12:28:00	200 °C	199.9444 °C	199.9562 °C	199.9254 °C	199.9504 °C	199.9456 °C	0.0556 °C

Certificado No.: 38316

Equipo (Instrument): Horno de Pozo Seco

Fecha de Calibración: 2023-09-21


Marca (Brand): Additel

Punto: 400 °C							
Hora (Time)	UBP (UUT)	Patrón de Ref (Ref. Standard)	Sensor #1 (Sensor #1)	Sensor #2 (Sensor #2)	Sensor #3 (Sensor #3)	Sensor #4 (Sensor #4)	Error (Error)
13:28:00	400 °C	400.0688 °C	400.0571 °C	400.0851 °C	400.0624 °C	400.0704 °C	-0.0688 °C
13:30:00	400 °C	400.0779 °C	400.0689 °C	400.0969 °C	400.0624 °C	400.0834 °C	-0.0779 °C
13:32:00	400 °C	400.0709 °C	400.0557 °C	400.0837 °C	400.0818 °C	400.0624 °C	-0.0709 °C
13:34:00	400 °C	400.0739 °C	400.0608 °C	400.0888 °C	400.064 °C	400.0818 °C	-0.0738 °C
13:36:00	400 °C	400.0732 °C	400.0602 °C	400.0882 °C	400.0624 °C	400.0818 °C	-0.0731 °C
13:38:00	400 °C	400.0758 °C	400.0639 °C	400.0919 °C	400.064 °C	400.0834 °C	-0.0758 °C
13:40:00	400 °C	400.0762 °C	400.0646 °C	400.0926 °C	400.064 °C	400.0834 °C	-0.0761 °C
13:42:00	400 °C	400.0739 °C	400.0616 °C	400.0896 °C	400.0624 °C	400.0818 °C	-0.0738 °C
13:44:00	400 °C	400.0732 °C	400.0602 °C	400.0882 °C	400.0624 °C	400.0818 °C	-0.0731 °C
13:46:00	400 °C	400.0715 °C	400.0593 °C	400.0873 °C	400.0607 °C	400.0785 °C	-0.0715 °C
13:48:00	400 °C	400.0700 °C	400.0564 °C	400.0844 °C	400.0607 °C	400.0785 °C	-0.0700 °C
13:50:00	400 °C	400.0667 °C	400.0513 °C	400.0793 °C	400.0591 °C	400.0769 °C	-0.0666 °C
13:52:00	400 °C	400.0736 °C	400.0602 °C	400.0882 °C	400.0624 °C	400.0834 °C	-0.0736 °C
13:54:00	400 °C	400.0707 °C	400.0593 °C	400.0873 °C	400.0591 °C	400.0769 °C	-0.0707 °C
13:56:00	400 °C	400.0743 °C	400.0608 °C	400.0888 °C	400.0640 °C	400.0834 °C	-0.0743 °C
13:58:00	400 °C	400.0732 °C	400.0586 °C	400.0866 °C	400.0640 °C	400.0834 °C	-0.0731 °C
14:00:00	400 °C	400.0722 °C	400.0624 °C	400.0904 °C	400.0591 °C	400.0769 °C	-0.0722 °C
14:02:00	400 °C	400.0700 °C	400.0564 °C	400.0844 °C	400.0607 °C	400.0785 °C	-0.0700 °C
14:04:00	400 °C	400.0667 °C	400.0513 °C	400.0793 °C	400.0591 °C	400.0769 °C	-0.0666 °C
14:06:00	400 °C	400.0736 °C	400.0602 °C	400.0882 °C	400.0624 °C	400.0834 °C	-0.0736 °C

Diagram de Posición de Sensores (Sensor Position Diagram)



- Leyenda:**
- PR:** Patrón de Referencia
- 1: Sensor #1
- 2: Sensor #2
- 3: Sensor #3
- 4: Sensor #4

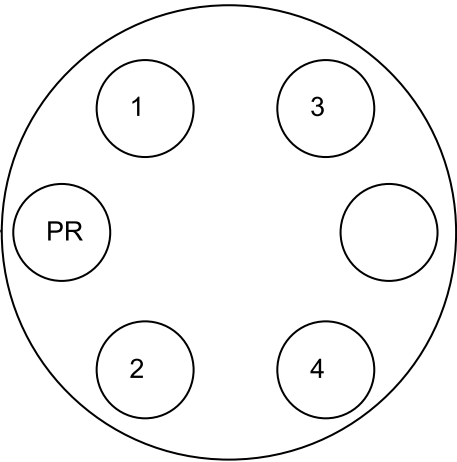

Las imagenes utilizadas solo son un ejemplo de lo puntos de medida empleados y posición de los sensores.