



ESTADO

✓ Hecho

PRIORIDAD

Alto

TIEMPO ESTIMADO

1h

TIPO DE TRABAJO

Preventivo

DESCRIPCIÓN

Revisión general, pruebas de funcionamiento (Pantalla, teclado (pantalla táctil), limpieza, pruebas básicas de desempeño: exactitud, linealidad, excentricidad. Comprobación de retorno a cero. Reporte estándar.

ASIGNADOS

 Manuel Meneses

CATEGORÍAS

Inspection

Mantenimiento Preventivo

UBICACIÓN

**Instituto Conmemorativo
Gorgas de E.S.**

Principal: INNOVATECIS, S.A.

ACTIVO

**51809 - Balanza Analítica
Mettler Toledo MS304TS -
ICGES**

 PROCEDIMIENTO**Balanza-Mantenimiento Preventivo****7 / 7**

Campos completados

 Descripción

Revisión general, limpieza y pruebas de desempeño

Revisión general:

- ☒ Inspección visual general
- ☒ Estado de corta aires
- ☒ Estado de pantalla(incluir protector o cubierta)
- ☒ Operación de teclado o pantalla táctil.
- ☒ Calentamiento de celda y funcionamiento preliminar
- ☒ Prueba de excentricidad 1
- ☒ Prueba de Repetibilidad 1
- ☒ Observaciones adicionales (instalación eléctrica, mesa de trabajo, etc.)
- ☒ Nivelación y patas ajustables

Rellenado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 12:10 PM

Limpieza General:

- ☒ Limpieza Externa
- ☒ Limpieza Interna
- ☒ Prueba de excentricidad 2
- ☒ Prueba de Repetibilidad 2



Rellenado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 12:10 PM

Estado actual del sistema(observaciones):

✓ Aprobado

Alerta

Falla

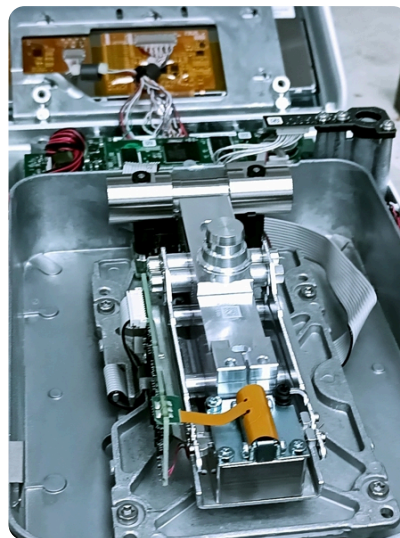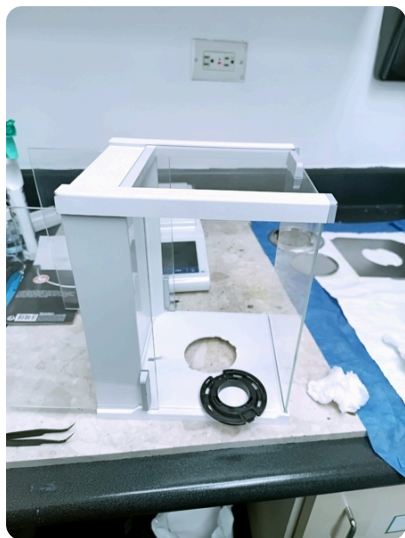

Notas:

Se realizaron todas las actividades sin contratiempos. Está balanza está funcionando correctamente.

Se observó que la superficie de trabajo es muy susceptible a desnivelarse, a diferencia de las dos Balanzas del área, posiblemente por tener una superficie mayor. Al tocar la mesa, se mueve la indicación.

Rellenado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 12:10 PM

Realiza la inspección :

M. MENESSES

Firmado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 12:14 PM

Fecha del servicio:

06/17/2025

Rellenado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 12:14 PM

Por parte del cliente :

T.G.

Firmado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 1:26 PM

Etiqueta de Mantenimiento :

☒ Colocada

Rellenado por Manuel Meneses el 06/17/2025, 1:19 PM

📘 INFORMACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO

Created by: Manuel Meneses on 06/17/2025, 11:11 AM

Last updated on 06/17/2025, 1:27 PM

Completado el 06/17/2025, 1:27 PM