Cert. #:4038.01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / *CALIBRATION CERTIFICATE*

INNOVATECIS CIA. LTDA.
JOSE MARIA GUERRERO N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO
QUITO, ECUADOR
(+593) 02 6040 607
innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. *(Certificate #):* 61308-B
Fecha de Recepción *(Reception Date):* 2025-09-15
Fecha de Calibración *(Calibration Date):* 2025-09-22
Próxima Fecha de Calibración *(Calibration Due):* 2026-09
Fecha de Emisión *(Emission Date):* 2025-09-23

Cliente *(Client):* QUIFATEX S.A.
Panamericana Norte km 14.5 entre pasaje Cenepa y Calle Leonidas Proaño, QUITO (PICHINCHA)

Información del Instrumento *(Instrument Information)*

Equipo *(Instrument):*	Termómetro (Datalogger - WIFI)	**Ubicación** *(Location):*		**Int. de Medición:** *(Measurement Range)*	(-30 a 70) °C
Marca *(Brand):*	LOGTAG	**Código** *(Code):*	Q-562		
Modelo *(Model):*	UTRID-16	**Lugar de Calibración** *(Place of Calibration):*	Lab. INNOVATEC (Ecuador)	**División de escala:** *(Resolution)*	0.1°C
Serie *(Serial #):*	6045027085				

Datos de Calibración *(Calibration Info)*
Procedimiento (Procedure): INN-PC-24 por Comparación

Condiciones Ambientales *(Enviromental Conditions)*
Temp. Inicial *(Initial Temp.):* 23.3 °C
Temp. Final *(Final Temp.):* 23.7 °C
Hum. Inicial *(Initial Hum.):* 46.91 %HR
Hum. Final *(Final Hum.):* 46.3 %HR

Trazabilidad *(Traceability Info)*

Patrón *(Standard)*	**Marca** *(Brand)*	**Cert. #**	**Ultima Calibración** *(Last Cal.)*	**Periódo** *(Period)*
TEMP/HUMIDITY SENSOR	CONTROL COMPANY	US011-MKE-CI-25281018	2025-07-17	2 Años

Resultados *(Results)*

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de k=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprovada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of k=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: *(Comments):*
UBP: Unidad bajo prueba / UUT: Unit under test
Los errores del instrumento cumple con los E.M.P. establecidos por Quifatex S.A.
INNOVATEC Industrial Solutions utiliza una regla de decisión simple a menos que se especifique a lo contrario, las incertidumbres no se incluyen en la determinación de Cumple / No Cumple. Intervalo de Calibración: (-25 a 40) °C
Cambio de certificado por trazabilidad.

Calibrado por: *(Calibrated by):* Patricio Junior Llerena Carvajal

Aprobado por: *(Approved by):*

Firmado electrónicamente por:
Ing. Mateo Borquez
Gerente Técnico

Fin de Certificado *(End of Certificate)*

Certificado No.: 61308-B
Fecha de Calibración: 2025-09-22

Equipo (Instrument): Termómetro (Datalogger - WIFI)
Marca (Brand): LOGTAG
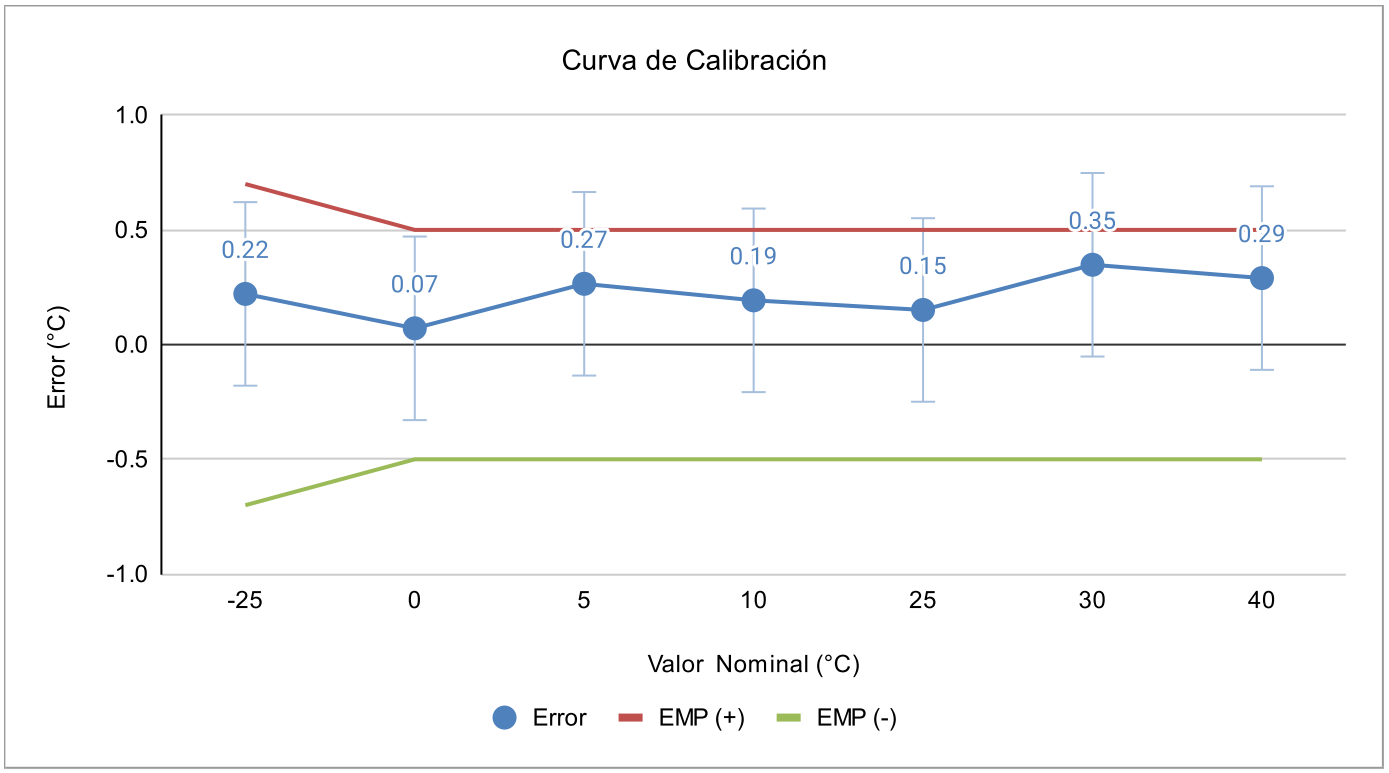
Nominal *(Nominal)*	**Patrón** *(Standard)*	**UBP** *(UUT)*	**Error** *(Error)*	**Exactitud** *(Accuracy)*	**Incertidumbre** *(Uncertainty)*
-25 ºC	-25.521 ºC	-25.3 ºC	0.221 ºC	± 0.70 ºC	± 4.0E-01 ºC
0 ºC	-0.171 ºC	-0.1 ºC	0.071 ºC	± 0.5 ºC	± 4.0E-01 ºC
5 ºC	5.635 ºC	5.9 ºC	0.265 ºC	± 0.5 ºC	± 4.0E-01 ºC
10 ºC	9.907 ºC	10.1 ºC	0.193 ºC	± 0.5 ºC	± 4.0E-01 ºC
25 ºC	25.149 ºC	25.3 ºC	0.151 ºC	± 0.5 ºC	± 4.0E-01 ºC
30 ºC	29.852 ºC	30.2 ºC	0.348 ºC	± 0.5 ºC	± 4.0E-01 ºC
40 ºC	40.010 ºC	40.3 ºC	0.290 ºC	± 0.5 ºC	± 4.0E-01 ºC