

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION *CERTIFICATE*

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 61862

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-09-30

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-10-06

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due):

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-10-06

Cliente (Client): SEROIL INSTRUMENTS CIA. LTDA.
FRANCISCO DE ORELLANA / KM 6 VIA A LAGO SN, PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (COCA), ORELLANA

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	HORNO DE POZO SECO	Int. de Medición: (Measurement Range)	(33 a 425) °C	Ubicación: (Location):	Almacenamiento de Muestras
Marca (Brand):	ADDITEL				
Modelo (Model):	ADT878PC-425	División de escala: (Resolution)	0.001 °C	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	In Situ On Site
Serie (Serial #):	670H22030002				
Código (Code #):	LAB-TEM-PAT-027				

Datos de Calibración (Calibration Info)**Procedimiento (Procedure):** INN-PC-29**Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)****Temp. Inicial (Initial Temp.):** 21.85 °C**Hum. Inicial (Initial Hum.):** 55.23 %HR**Temp. Final (Final Temp.):** 22.33 °C**Hum. Final (Final Hum.):** 52.68 %HR**Trazabilidad (Traceability Info)**

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Advanced Multimeter	Transmille	51065	2024-03-26	2 años
PRT	ISOTECH	AC-31859	2025-06-30	2 años
Termocupla	-	56708 / 56709 / 56710 / 56711	2025-05-14	1 año
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjunta

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Los resultados son un promedio de los datos tomados durante la calibración.
Comments


Calibrado por: Ing. Patricio Llerena
Calibrated by:

Aprobado por:
Approved by:

**Fin de Certificado (End of Certificate)**

Certificado No.:		61862		Equipo (Instrument): HORNO DE POZO SECO			
Fecha de Calibración:		2025-10-06		Marca (Brand): ADDITEL			
Nominal (Nominal)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Precisión (Accuracy)	Estabilidad (Stability)	Uniformidad (Uniformity)	Incertidumbre (Uncertainty)
50 °C	50.1458 °C	50.000 °C	-0.1458 °C	± 0.2 °C	0.076 °C	0.087 °C	± 0.07 °C
200 °C	200.0900 °C	200.002 °C	-0.0880 °C	± 0.2 °C	0.080 °C	0.100 °C	± 0.16 °C
400 °C	400.1394 °C	400.001 °C	-0.1384 °C	± 0.2 °C	0.139 °C	0.061 °C	± 0.18 °C

Diagram de Posición de Sensores (Sensor Position Diagram)

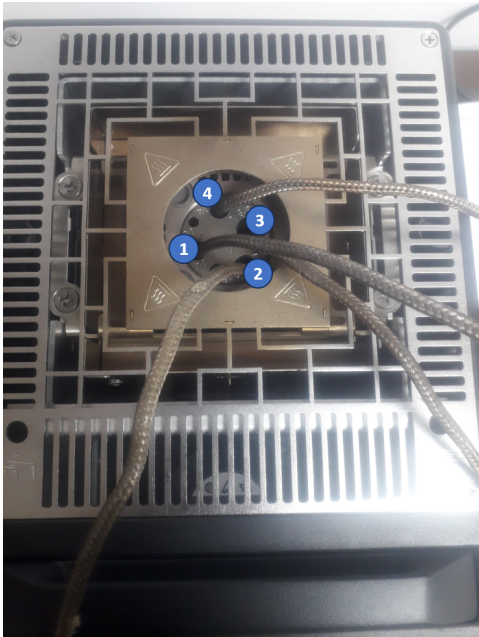

Leyenda:

- 1: Sensor #1
- 2: Sensor #2
- 3: Sensor #3
- 4: Sensor #4

Las imagenes utilizadas solo son un ejemplo de lo puntos de medida empleados y posición de los sensores.

Certificado No.: 61862


Equipo (Instrument): HORNO DE POZO SECO

Fecha de Calibración: 2025-10-06

Marca (Brand): ADDITEL

Hora (Time)	UBP (UUT)	Patrón de Ref (Ref. Standard)	Sensor #1 (Sensor #1)	Sensor #2 (Sensor #2)	Sensor #3 (Sensor #3)	Sensor #4 (Sensor #4)	Sensor #5 (Sensor #5)	Sensor #6 (Sensor #6)	Sensor #7 (Sensor #7)	Sensor #8 (Sensor #8)	Error (Error)
12:40:00	50.000 °C	50.1325 °C	50.130 °C	50.170 °C	50.160 °C	50.070 °C					-0.1325 °C
12:41:00	50.001 °C	50.1650 °C	50.140 °C	50.190 °C	50.130 °C	50.200 °C					-0.1640 °C
12:42:00	50.000 °C	50.1575 °C	50.160 °C	50.180 °C	50.090 °C	50.200 °C					-0.1575 °C
12:43:00	49.999 °C	50.1475 °C	50.140 °C	50.160 °C	50.090 °C	50.200 °C					-0.1485 °C
12:44:00	50.000 °C	50.1850 °C	50.150 °C	50.190 °C	50.170 °C	50.230 °C					-0.1850 °C
12:45:00	50.000 °C	50.1425 °C	50.160 °C	50.150 °C	50.070 °C	50.190 °C					-0.1425 °C
12:46:00	50.000 °C	50.1550 °C	50.150 °C	50.180 °C	50.090 °C	50.200 °C					-0.1550 °C
12:47:00	50.000 °C	50.1350 °C	50.120 °C	50.160 °C	50.080 °C	50.180 °C					-0.1350 °C
12:48:00	50.000 °C	50.1575 °C	50.170 °C	50.180 °C	50.070 °C	50.210 °C					-0.1575 °C
12:49:00	50.000 °C	50.1450 °C	50.140 °C	50.170 °C	50.090 °C	50.180 °C					-0.1450 °C
12:50:00	49.999 °C	50.1500 °C	50.160 °C	50.180 °C	50.100 °C	50.160 °C					-0.1510 °C
12:51:00	50.001 °C	50.1400 °C	50.140 °C	50.140 °C	50.120 °C	50.160 °C					-0.1390 °C
12:52:00	50.002 °C	50.1575 °C	50.180 °C	50.180 °C	50.100 °C	50.170 °C					-0.1555 °C
12:53:00	50.002 °C	50.1425 °C	50.130 °C	50.170 °C	50.100 °C	50.170 °C					-0.1405 °C
12:54:00	50.001 °C	50.1250 °C	50.140 °C	50.140 °C	50.070 °C	50.150 °C					-0.1240 °C
12:55:00	50.000 °C	50.1200 °C	50.150 °C	50.130 °C	50.100 °C	50.100 °C					-0.1200 °C
12:56:00	50.000 °C	50.1400 °C	50.140 °C	50.140 °C	50.160 °C	50.120 °C					-0.1400 °C
12:57:00	50.001 °C	50.1425 °C	50.140 °C	50.130 °C	50.130 °C	50.170 °C					-0.1415 °C
12:58:00	50.001 °C	50.1325 °C	50.160 °C	50.090 °C	50.120 °C	50.160 °C					-0.1315 °C
12:59:00	50.000 °C	50.1425 °C	50.160 °C	50.090 °C	50.150 °C	50.170 °C					-0.1425 °C

Graficos (Graphs):

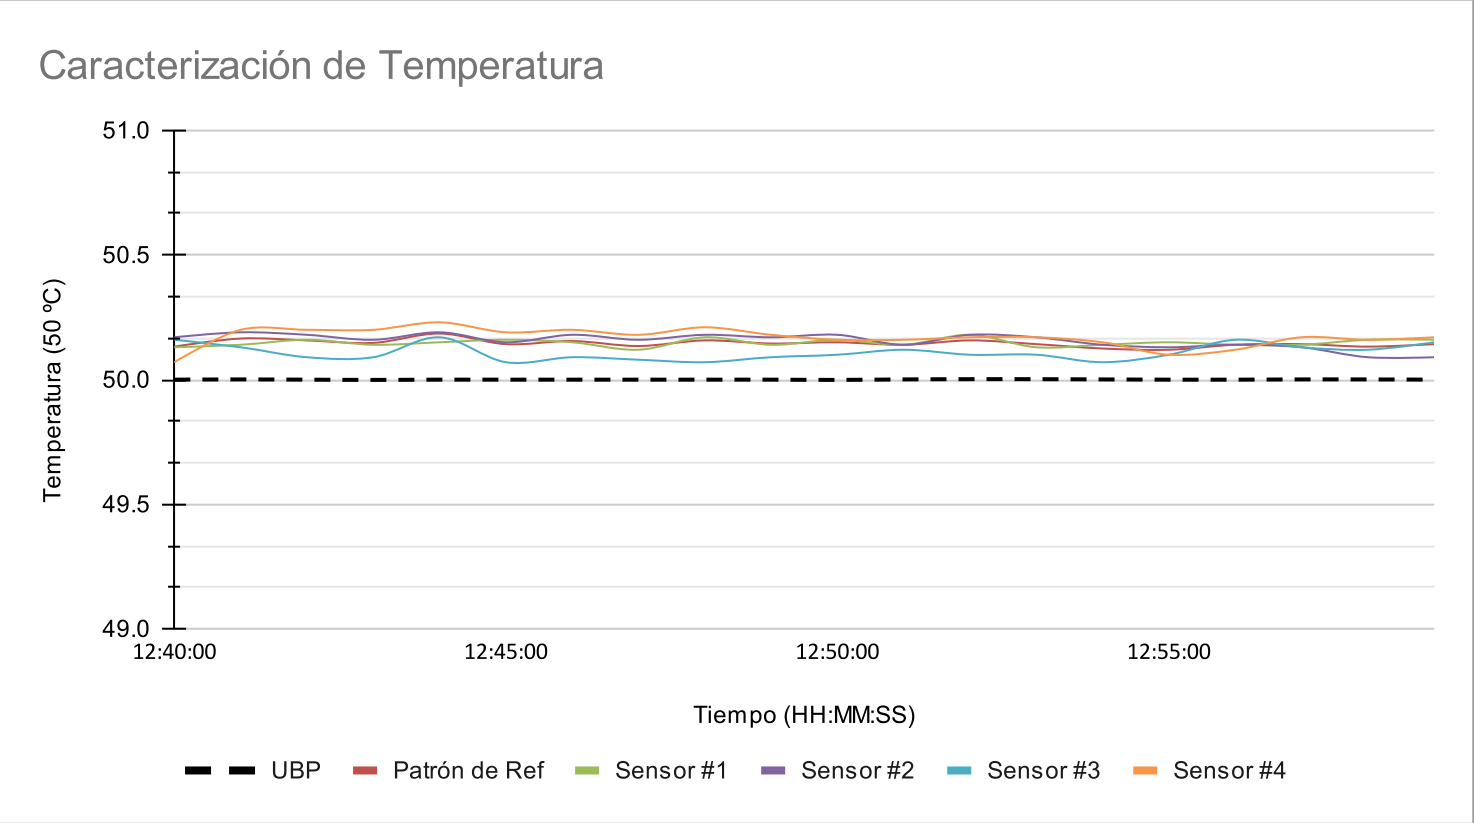

Certificado No.:61862


Equipo (Instrument):HORNO DE POZO SECO

Fecha de Calibración:2025-10-06

Marca (Brand):ADDITEL

Hora (Time)	UBP (UUT)	Patrón de Ref (Ref. Standard)	Sensor #1 (Sensor #1)	Sensor #2 (Sensor #2)	Sensor #3 (Sensor #3)	Sensor #4 (Sensor #4)	Sensor #5 (Sensor #5)	Sensor #6 (Sensor #6)	Sensor #7 (Sensor #7)	Sensor #8 (Sensor #8)	Error (Error)
13:30:00	200.001 °C	200.1000 °C	200.130 °C	200.130 °C	200.070 °C	200.070 °C					-0.0990 °C
13:31:00	200.003 °C	200.0925 °C	200.100 °C	200.110 °C	200.050 °C	200.110 °C					-0.0895 °C
13:32:00	200.000 °C	200.0850 °C	200.110 °C	200.110 °C	200.050 °C	200.070 °C					-0.0850 °C
13:33:00	199.999 °C	200.0950 °C	200.110 °C	200.100 °C	200.040 °C	200.130 °C					-0.0960 °C
13:34:00	200.002 °C	200.0950 °C	200.120 °C	200.120 °C	200.030 °C	200.110 °C					-0.0930 °C
13:35:00	200.002 °C	200.0975 °C	200.110 °C	200.140 °C	200.090 °C	200.050 °C					-0.0955 °C
13:36:00	200.000 °C	200.0875 °C	200.150 °C	200.100 °C	200.010 °C	200.090 °C					-0.0875 °C
13:37:00	200.002 °C	200.0775 °C	200.140 °C	200.090 °C	200.040 °C	200.040 °C					-0.0755 °C
13:38:00	199.998 °C	200.1025 °C	200.100 °C	200.130 °C	200.090 °C	200.090 °C					-0.1045 °C
13:39:00	199.998 °C	200.0925 °C	200.130 °C	200.130 °C	200.080 °C	200.030 °C					-0.0945 °C
13:40:00	200.000 °C	200.0925 °C	200.120 °C	200.130 °C	200.070 °C	200.050 °C					-0.0925 °C
13:41:00	200.000 °C	200.1125 °C	200.150 °C	200.160 °C	200.040 °C	200.100 °C					-0.1125 °C
13:42:00	200.002 °C	200.0775 °C	200.100 °C	200.120 °C	200.030 °C	200.060 °C					-0.0755 °C
13:43:00	200.003 °C	200.0725 °C	200.120 °C	200.090 °C	200.030 °C	200.050 °C					-0.0695 °C
13:44:00	200.003 °C	200.0750 °C	200.130 °C	200.100 °C	200.010 °C	200.060 °C					-0.0720 °C
13:45:00	200.001 °C	200.0925 °C	200.120 °C	200.120 °C	200.010 °C	200.120 °C					-0.0915 °C
13:46:00	200.003 °C	200.0975 °C	200.110 °C	200.140 °C	200.020 °C	200.120 °C					-0.0945 °C
13:47:00	200.004 °C	200.1125 °C	200.140 °C	200.130 °C	200.070 °C	200.110 °C					-0.1085 °C
13:48:00	200.007 °C	200.0850 °C	200.060 °C	200.060 °C	200.090 °C	200.130 °C					-0.0780 °C
13:49:00	200.003 °C	200.0575 °C	200.020 °C	200.050 °C	200.050 °C	200.110 °C					-0.0545 °C

Graficos (Graphs):

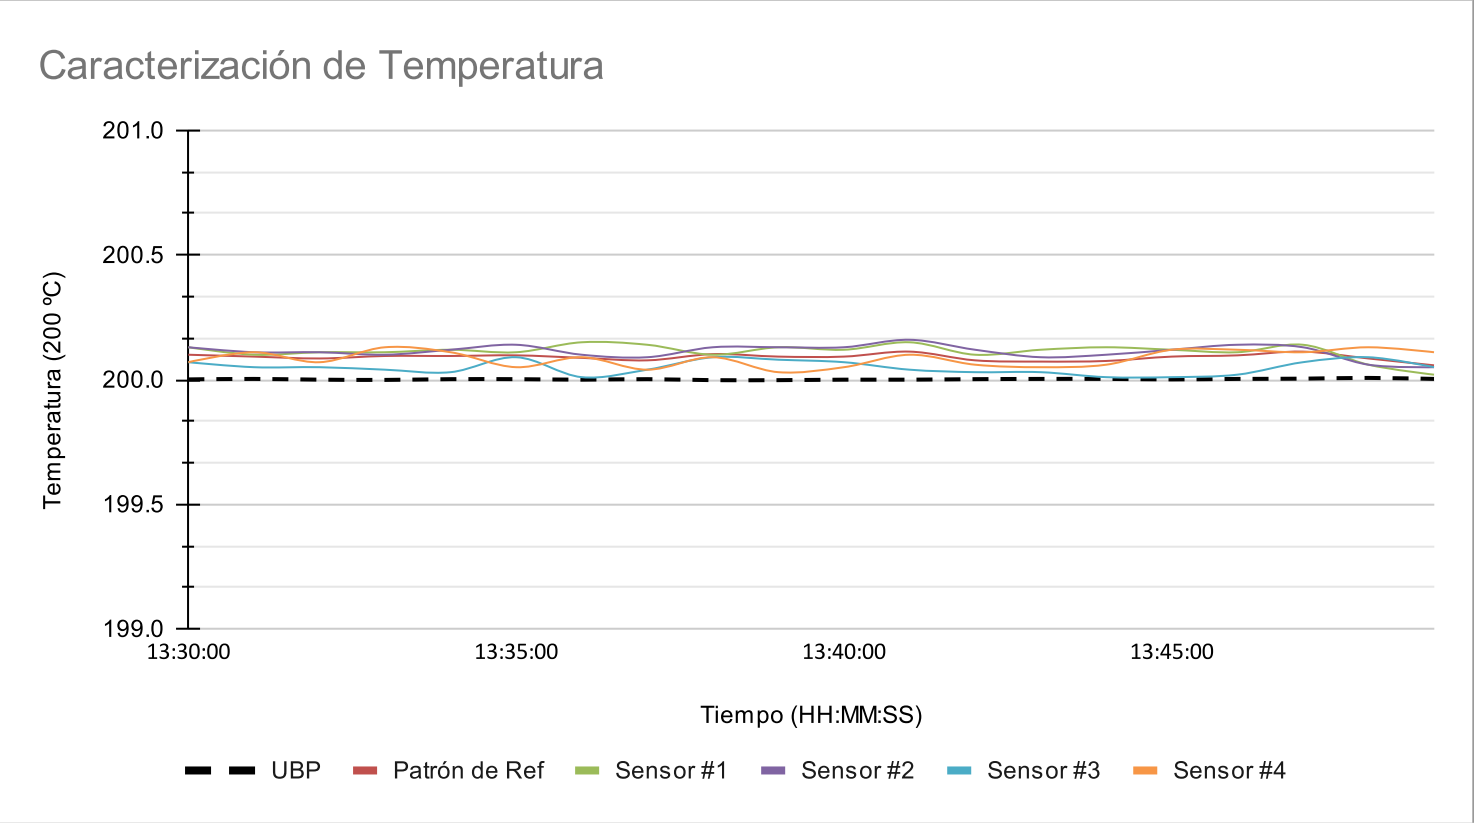

Certificado No.: 61862

Equipo (Instrument): HORNO DE POZO SECO

Fecha de Calibración: 2025-10-06

Marca (Brand): ADDITEL

Hora (Time)	UBP (UUT)	Patrón de Ref (Ref. Standard)	Sensor #1 (Sensor #1)	Sensor #2 (Sensor #2)	Sensor #3 (Sensor #3)	Sensor #4 (Sensor #4)	Sensor #5 (Sensor #5)	Sensor #6 (Sensor #6)	Sensor #7 (Sensor #7)	Sensor #8 (Sensor #8)	Error (Error)
14:40:00	400.001 °C	400.1400 °C	400.200 °C	400.070 °C	400.170 °C	400.120 °C					-0.1390 °C
14:41:00	400.001 °C	400.1700 °C	400.190 °C	400.090 °C	400.210 °C	400.190 °C					-0.1690 °C
14:42:00	400.004 °C	400.1775 °C	400.180 °C	400.100 °C	400.230 °C	400.200 °C					-0.1735 °C
14:43:00	400.001 °C	400.1800 °C	400.170 °C	400.110 °C	400.260 °C	400.180 °C					-0.1790 °C
14:44:00	399.999 °C	400.1475 °C	400.130 °C	400.080 °C	400.250 °C	400.130 °C					-0.1485 °C
14:45:00	400.001 °C	400.1725 °C	400.160 °C	400.120 °C	400.240 °C	400.170 °C					-0.1715 °C
14:46:00	400.000 °C	400.1575 °C	400.170 °C	400.090 °C	400.240 °C	400.130 °C					-0.1575 °C
14:47:00	400.000 °C	400.1350 °C	400.120 °C	400.080 °C	400.220 °C	400.120 °C					-0.1350 °C
14:48:00	400.003 °C	400.1200 °C	400.120 °C	400.050 °C	400.200 °C	400.110 °C					-0.1170 °C
14:49:00	400.002 °C	400.1325 °C	400.170 °C	400.060 °C	400.220 °C	400.080 °C					-0.1305 °C
14:50:00	400.001 °C	400.1250 °C	400.150 °C	400.030 °C	400.230 °C	400.090 °C					-0.1240 °C
14:51:00	400.000 °C	400.1200 °C	400.140 °C	400.020 °C	400.210 °C	400.110 °C					-0.1200 °C
14:52:00	400.002 °C	400.1275 °C	400.170 °C	400.000 °C	400.220 °C	400.120 °C					-0.1255 °C
14:53:00	400.004 °C	400.1275 °C	400.180 °C	400.040 °C	400.210 °C	400.080 °C					-0.1235 °C
14:54:00	400.002 °C	400.1200 °C	400.150 °C	400.000 °C	400.210 °C	400.120 °C					-0.1180 °C
14:55:00	400.002 °C	400.110 °C	400.160 °C	400.000 °C	400.190 °C	400.090 °C					-0.1080 °C
14:56:00	400.001 °C	400.1175 °C	400.130 °C	400.030 °C	400.200 °C	400.110 °C					-0.1165 °C
14:57:00	400.000 °C	400.1375 °C	400.170 °C	400.000 °C	400.210 °C	400.170 °C					-0.1375 °C
14:58:00	400.001 °C	400.1275 °C	400.160 °C	400.010 °C	400.180 °C	400.160 °C					-0.1265 °C
14:59:00	400.003 °C	400.1425 °C	400.170 °C	400.010 °C	400.210 °C	400.180 °C					-0.1395 °C

Graficos (Graphs):

